


# CLICKTEST<sup>2H</sup>



## PT INDICADORES BIOLÓGICOS VAPOR DE BAIXA TEMPERATURA E FORMALDEÍDO 2H (IBFF2H)

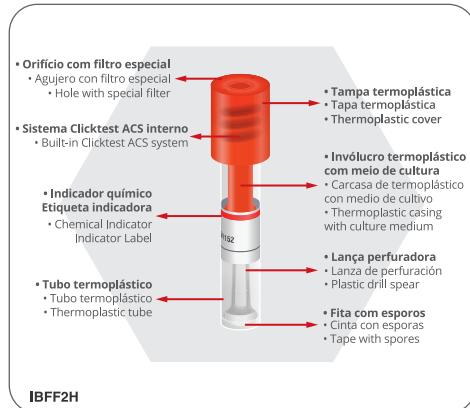

### ► DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Indicador Biológico Fluorimétrico **CLICKTEST – IBFF2H (VBTF)** foi desenvolvido para monitorar processos de esterilização por mistura de vapor de baixa temperatura e formaldeído e em temperaturas compreendentes entre 50°C e 80°C. Possibilita comprovar de forma rápida, eficiente e segura a letalidade microbiana dos ciclos de esterilização.

Seu design inovador dispensa componentes de vidro e, aliado a um exclusivo sistema de açãoamento, simplifica o uso e proporciona manuseio seguro ao prevenir qualquer risco de acidentes.

O Indicador Biológico Fluorimétrico **CLICKTEST – IBFF2H (VBTF)** está disponível em caixas com 50 unidades e em conformidade com as Normas AAMI/ISO 11138-1, AAMI/ISO 11138-5 e AAMI/ISO 1140-1.

### ► COMPOSIÇÃO

Cada Indicador Biológico Fluorimétrico **CLICKTEST – IBFF2H (VBTF)** é confeccionado com tubo termoplástico, ACS em aço inoxidável, filtro especial, etiqueta adesiva com indicador químico de processo (Tipo 1), população mínima de  $1 \times 10^6$  de esporos de *Geobacillus stearothermophilus* (ATCC 7953) inoculada em tira portadora de esporos. Possui também meio de cultivo de cor purpura contido em invólucro e tampa termoplástica com orifícios, acrescida de barreira permeável ao agente esterilizante.

### ► INSTRUÇÕES DE USO

1. Identifique o Indicador Biológico Fluorimétrico **CLICKTEST – IBFF2H (VBTF)** escrevendo em sua etiqueta o número do esterilizador, o número do ciclo/carga e a data de processamento.

2. Embale o indicador biológico em um pacote padronizado segundo as práticas recomendadas de esterilização (ANMSA, SOBECC, APECIH etc.) e validado na instituição.

3. Coloque o pacote junto aos materiais a serem esterilizados, em área considerada crítica (de maior desafio) à autoclave, geralmente situada no centro da carga ou próxima à porta e junto ao dreno.

4. Selecione e aione o ciclo de esterilização correspondente à carga a ser

processada. Ao final do ciclo, segundo as recomendações de segurança do fabricante da autoclave, abra a câmara e retire com cuidado o indicador biológico do interior do pacote.

5. Verifique se o indicador químico externo Tipo 1 (contido na etiqueta) alterou a sua cor vermelha (original) para a cor verde, confirmando apenas que houve exposição ao vapor de baixa temperatura e formaldeído.

**Importante:** a mudança da cor não é evidência de que o ciclo de esterilização foi bem-sucedido. Caso não ocorra alteração de cor será necessário revisar o processo de esterilização.

6. Aione o Indicador Biológico Fluorimétrico **CLICKTEST – IBFF2H (VBTF)**. Para isso, segure a ampola e pressione a tampa para baixo **até ouvir um "click"**, rompendo o fácre retentor do meio de cultivo. Agite-a **até que todo o líquido** (meio de cultivo) **desça completamente** da tampa e entre em contato com a tira portadora de esporos (vide Manual Rápido contido neste documento).

7. Pegue outro Indicador Biológico Fluorimétrico **CLICKTEST – IBFF2H (VBTF)**, que **NÃO tenha sido submetido ao processo de esterilização**, para ser utilizado como controle positivo, a fim de validar as condições de incubação (temperatura e tempo), aferir a viabilidade dos esporos e a capacidade do meio de cultura em promover a germinação dos esporos. Ambos os indicadores biológicos (processado e controle positivo) devem pertencer ao mesmo lote de fabricação. Repita o passo 1 (identificação) e o passo 6 (acionamento).

8. Verifique se a incubadora com **tecnologia por fluorescência** está operando entre 58°C e 62°C e se o tempo programado é compatível com o dos indicadores de 02 horas.

### RESULTADO POR LEITURA RÁPIDA - METODOLOGIA FLUORIMÉTRICA

Incube os 02 indicadores biológicos (processado e controle positivo) pelo período de 02 horas. Após o término da incubação observar:

a) se o leitor da incubadora **NÃO** detectou reação fluorimétrica no **indicador processado**, caracteriza **resultado negativo** e ciclo de esterilização bem-sucedido pela inativação da população de esporos;

b) a detecção de fluorescência pela incubadora significa **resultado positivo** pela sobrevivência de microrganismos e ciclo falho de esterilização.

9. Libere o carregamento/carga para uso somente se o Indicador Biológico Fluorimétrico **CLICKTEST – IBFF2H (VBTF)** processado apresentar resultado “Negativo – Ausência de Microrganismos” e o **indicador de controle** resultar “Positivo – Presença de Microrganismos”, confirmando que o ciclo de esterilização foi satisfatório e que a incubação e a detecção de fluorescência foram adequadas.

**Observação:** caso o indicador biológico processado aponte resultado “Positivo – Presença de Microrganismos” e, consequentemente, irregularidade no ciclo de esterilização, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e a Engenharia/Manutenção devem ser notificadas para adoção das providências cabíveis.

10. Destaque as etiquetas dos indicadores biológicos (processado e controle positivo), anexe-as ao livro/prontuário designado para tal e registre os respectivos resultados obtidos.

11. Descarte os tubos/ampolas dos indicadores biológicos de acordo com as regulamentações sanitárias da sua região. Os indicadores positivos podem ser esterilizados em ciclos a vapor de 121°C por 15 minutos ou 132°C por 10 minutos em autoclaves gravitacionais; ou em ciclos de 134°C por 04 minutos em autoclaves assistidas por bomba de vácuo.

Todos os materiais que compõem o Indicador Biológico Fluorimétrico **CLICKTEST – IBFF2H (VBTF)** são 100% recicláveis, obedecendo ao plano institucional MAXXIMED de design ecológico.

**OBSERVAÇÃO:** caso necessite é possível ratificar o resultado obtido por leitura rápida complementando com metodologia colorimétrica (leitura por mudança de cor do meio de cultura) da seguinte forma:

### RESULTADO POR LEITURA VISUAL

- **Não execute os passos 9, 10 e 11 anteriores.**

- Verifique se a incubadora está operando entre 58°C e 62°C. Incube os 02 indicadores biológicos pelo período de 24 horas para obter o resultado por

leitura visual por meio de metodologia colorimétrica (mudança de coloração do meio de cultivo). Considerando que a presença de microrganismos poderá ser detectada antes de 24 horas, recomenda-se efetuar leituras a cada 04 horas. Resultados:

a) manutenção da cor purpura do meio de cultivo indica ausência de microrganismos viáveis e, portanto, processo de esterilização bem-sucedido e **resultado satisfatório**.

b) alteração da cor do meio de cultivo, de purpura para cinza/esverdeado e posteriormente para a cor amarela, indica presença/ sobrevivência de microrganismos e, portanto, falha no ciclo de esterilização e **resultado insatisfatório**.

- Realize os passos 9, 10 e 11 anteriores.

**IMPORTANTE:** a leitura rápida Fluorimétrica de 02 horas e a leitura opcional Colorimétrica de 24 horas estão correlacionadas com a incubação de 07 dias, conforme protocolo de tempo reduzido de incubação (FRT) do FDA, e seus resultados tem uma correlação de  $> = 97\%$  dos casos.

**ATENÇÃO:** não use o Indicador Biológico Fluorimétrico **CLICKTEST – IBFF2H (VBTF)** para monitor ciclos de esterilização por óxido de eteno, calor seco, plasma/vaporização de peróxido de hidrogênio, vapor saturado, vapores químicos, radiação ou outros processos de esterilização que não usem vapor a baixa temperatura e formaldeído como agente esterilizante. Não reutilize os indicadores biológicos.

### ► VALIDADE / REGISTRO ANVISA

O Indicador Biológico Fluorimétrico **CLICKTEST – IBFF2H (VBTF)** possui validade de 02 anos a partir da data de fabricação. Informações sobre lote e data de vencimento estão impressas na embalagem e no tubo do indicador biológico. Produto isento de registro junto à Anvisa, conforme RDC 185/2001.

### ► ARMAZENAGEM

Conservar ao abrigo da luz, em temperaturas entre 15°C e 30°C e umidade relativa entre 35% e 60%. Não congelar. Não armazenar em contato com pisos e paredes ou próximo de fontes de calor, de agentes esterilizantes e de outros produtos químicos.

### ► MANUAL RÁPIDO / QUICK MANUAL

1. Leve a ampola para o processo de esterilização na autoclave, conforme procedimento padrão. / (ES) Llevar la ampolla al proceso de esterilización en autoclave, según procedimiento estándar. / (EN) Take the ampoule to the sterilization process in the Auto-Reader Incubator, according to standard procedure.

2. Após o processo de esterilização, segure a ampola, pressione a tampa para baixo até romper o fácre retentor do meio de cultivo. / (ES) Después del proceso de esterilización, sostenga la ampolla, presione la tapa hacia abajo hasta que se rompa el sellito de retención del medio de cultivo. / (EN) After the sterilization process, hold the ampoule and press the lid until the retaining seal of the culture medium is broken.


3. Agite a ampola até que o meio de cultivo entre em contato com o portador de esporos (movimento similar ao utilizado para baixar temperatura num termômetro de mercúrio). / (ES) / Agitar la ampolla hasta que el medio de cultivo entre en contacto con el portador de esporas (movimiento similar al que se usa para bajar la temperatura en un termómetro de mercurio). / (EN) Shake the ampoule until the culture medium comes into contact with the spore carrier (a movement similar to that used to lower the temperature of a mercury thermometer).

4. Coloque o Indicador Biológico esterilizado e o controle positivo na incubadora por fluorescência pelo período de 02 horas. Aguarde os resultados da incubadora e registre-os. / (ES) Ponga el indicador biológico estéril y el control positivo en la incubadora de fluorescencia durante 02 horas. Espere los resultados de la incubadora y registrélos. / (EN) Place the sterile Biological Indicator and Positive Control in the fluorescence incubator for 02 hours. Wait for the results from the incubator and record them.

5. Leitura Visual: após 24 horas de incubação, o indicador biológico **processado** deverá permanecer na cor purpura, indicando a ausência de microrganismos

viáveis e a efetividade do processo de esterilização. / (ES) Lectura Visual: después de 24 horas de incubación, el indicador biológico **procesado** debe permanecer en color púrpura, indicando la ausencia de microorganismos viables y la efectividad del proceso de esterilización. / (EN) Visual Reading: after 24 hours of incubation, the **processed** biological indicator should remain in purple color, indicating the absence of viable microorganisms and the effectiveness of the sterilization process.

6. Leitura Visual: após 24 horas de incubação, o **control positivo** deverá alterar sua cor para amarela, indicando a presença de microrganismos viáveis e validando o processo de incubação. / (ES) Lectura visual: después de 24 horas de incubación, el **control positivo** debe cambiar su color a amarillo, indicando la presencia de microorganismos viables y validando el proceso de incubación. / (EN) Visual reading: after 24 hours of incubation, the **positive control** should change its color to yellow, indicating the presence of viable microorganisms and validating the incubation process.

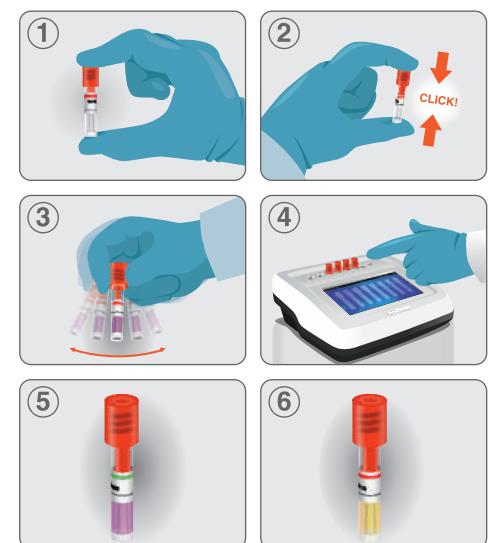

**IMPORTANTE:** transportar, armazenar, ativar, incubar e descartar sempre na posição vertical (tampa para cima) para evitar vazamentos após a ativação do produto.

### ► REFERÊNCIAS

- ANSI/AAMI/ISO 11138-1:2006, Sterilization of health care products Biological Indicators Part 1: General requirements.
- ANSI/AAMI/ISO 11138-5: Biological Indicators for Low Temperature Steam Sterilization and Formaldehyde Processes.
- ANSI/AAMI/ISO 1140-1: Sterilization of health care products – Chemical indicators - Part 1: General requirements.



# CLICKTEST<sup>2H</sup>

## INDICADORES BIOLÓGICOS VAPOR DE BAJA TEMPERATURA Y FORMALDEHÍDO 2H (IBFF2H)

### ► DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Indicador Biológico Fluorimétrico **CLICKTEST - IBFF2H (VBT)** fue desarrollado para monitorear procesos de esterilización por mezcla de vapor a baja temperatura y formaldehído a temperaturas entre 50°C y 80°C. Permite probar de manera eficiente y segura la letalidad microbiológica de los ciclos de esterilización.

Su innovador diseño prescinde de componentes de vidrio y, combinado con un exclusivo sistema de accionamiento, simplifica el uso y proporciona un manejo seguro evitando cualquier riesgo de accidente.

El Indicador Biológico Fluorimétrico **CLICKTEST - IBFF2H (VBT)** está disponible en cajas de 50 unidades y cumple con las Normas AAMI/ISO 11138-1, AAMI/ISO 11138-2 y AAMI/ISO 11140-1.

### ► COMPOSICIÓN

Cada Indicador Biológico Fluorimétrico **CLICKTEST - IBFF2H (VBT)** está fabricado con tubo termoplástico, acero inoxidable ACS, filtro especial, etiqueta adhesiva con indicador químico de proceso (Tipo 1), población mínima de  $1 \times 10^6$  esporas de Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953) incubadas en una tira con esporas. Contiene también un medio de cultivo de color púrpura en un envoltorio y una tapa termoplástica con orificios, adicionada con una barrera permeable al agente esterilizante.

### ► INSTRUCCIONES DE USO

1. Identifique el Indicador Biológico Fluorimétrico **CLICKTEST - IBFF2H (VBT)** escribiendo el número de esterilizador, el número de ciclo/carga y la fecha de procesamiento en su etiqueta.

2. Envíe el indicador biológico en envase estandarizado de acuerdo con las prácticas de esterilización recomendadas y validado en la institución.

3. Ponga el paquete junto a los materiales a esterilizar, en un área considerada crítica (de mayor desafío) de la autoclave, generalmente ubicada en el centro de la carga o cerca de la puerta y al lado del desagüe.

4. Seleccionar y activar el ciclo de esterilización correspondiente a la carga a procesar. Al final del ciclo, siguiendo las recomendaciones de seguridad del fabricante de la autoclave, abra la cámara y retire con cuidado el indicador biológico del interior del paquete.

5. Verifique que el indicador químico externo Tipo 1 (contenido en la etiqueta del indicador biológico) haya cambiado de su color rojo (original) a verde, confirmando solo que ha habido exposición a vapor a baja temperatura y formaldehído.

**Importante:** El cambio de color no es evidencia de que el ciclo de esterilización haya sido exitoso. Si no hay cambio de color, será necesario revisar el proceso de esterilización.

6. Activar el Indicador Biológico Fluorimétrico **CLICKTEST - IBFF2H (VBT)**. Para ello, sostenga la ampolla y presione la tapa hacia arriba **hasta escuchar un "click"**, rompiendo el sellado de retención del medio de cultivo. Agitar **hasta que todo el líquido** (medio de cultivo) **descienda completamente** de la tapa y haga contacto con la tira que contiene las esporas (consulte el Manual rápido que se incluye en este documento).

7. Tomar otro Indicador Biológico Fluorimétrico **CLICKTEST - IBFF2H (VBT)**, que **NO haya sido sometido al proceso de esterilización**, para ser utilizado como control positivo, con el fin de validar las condiciones de incubación (temperatura y tiempo), la viabilidad de las esporas y la cualificación del medio de cultivo. Ambos indicadores biológicos (procesado y control positivo) deben pertenecer al mismo lote de fabricación. Repita el paso 1 (identificación) y el paso 6 (gatillo).

8. Verifique que la incubadora con **tecnología de fluorescencia** esté funcionando entre 58°C y 62°C y que el tiempo programado sea compatible con los dos indicadores biológicos de 2 horas.

### RESULTADO DE LECTURA RÁPIDA - METODOLOGÍA FLUORIMÉTRICA

Incubar los 02 indicadores biológicos (procesado y control positivo) por un período de 02 horas. Después del final de la incubación observar:

a) si el lector de la incubadora **NO** detectó una reacción fluorimétrica en el **indicador procesado**, caracteriza un **resultado negativo** y una esterilización ácida exitosa

dado a la inactivación de la población de esporas;

b) la detección de fluorescencia por la incubadora significa un **resultado positivo** debido a la supervivencia de microorganismos y un ciclo de esterilización fallido.

9. Libere la carga para usarla sólo si el Indicador Biológico Fluorimétrico **CLICKTEST - IBFF2H (VBT)** procesado devuelve **Negativo - Ausencia de microorganismos** y los resultados del **indicador de control positivo** **"Positivo - Presencia de Microorganismos"**, confirmando que el ciclo de esterilización fue satisfactorio y que la incubación y detección de fluorescencia fueron adecuadas.

**Nota:** si el indicador biológico procesado muestra un resultado **"Positivo - Presencia de Microorganismos"** y, en consecuencia, irregularidad en el ciclo de esterilización, se deberá notificar al Control de Calidad e Ingeniería/Mantenimiento para la adopción de las medidas oportunas.

10. Despegar las etiquetas de los indicadores biológicos (procesados control positivo), adjuntarlos al libro/manual designado para tal fin y registrar los respectivos resultados obtenidos.

11. Deseche las ampollas/tubos indicadores biológicos de acuerdo con las normas sanitarias de su región. Los indicadores positivos pueden esterilizarse en ciclos de vapor de 121°C por 15 minutos o 132°C por 10 minutos en autoclaves de gravedad; o en ciclos de 134°C durante 04 minutos en autoclaves por bomba de vacío.

Todos los materiales que componen el Indicador Biológico Fluorimétrico **CLICKTEST - IBFF2H (VBT)** son 100% reciclables, cumpliendo con el plan de diseño de diseño ecológico MAXXIMED.

### RESULTADO POR LECTURA VISUAL

#### - No realice los pasos 9, 10 y 11 anteriores.

- Compruebe que la incubadora esté funcionando entre 58°C y 62°C. Incubar los 02 indicadores biológicos por un lapso de 24 horas para obtener el resultado por lectura visual mediante metodología colorímetrica (cambio de color del medio de cultivo). Considerando que la presencia de microorganismos puede detectarse antes de las 24 horas, se recomienda realizar cada 04 horas. Resultados:

a) el mantenimiento del color púrpura del medio de cultivo indica la ausencia de microorganismos viables y, por lo tanto, un proceso de esterilización exitoso y **resultado satisfactorio**;

b) el cambio en el color del medio de cultivo, de púrpura a gris/verdoso y luego a amarillo, indica la presencia/supervivencia de microorganismos y, por lo tanto, falla en el ciclo de esterilización y **resultado no satisfactorio**.

#### - Realice los pasos 9, 10 y 11 anteriores.

**IMPORTANTE:** La lectura fluorimétrica rápida de 02 horas y la lectura colorímetrica opcional de 24 horas se correlacionan con la incubación de 07 días, según el protocolo de incubación de tiempo reducido (RIT) de la FDA, y sus resultados tienen una correlación de > = 97 % de los casos.

**PRECAUCIÓN:** No use el Indicador Biológico Fluorimétrico **CLICKTEST - IBFF2H (VBT)** para monitorear ciclos de esterilización con óxido de etileno, calor seco, vaporización de plasma/peróxido de hidrógeno, vapor saturado, vapores químicos, radiación u otros procesos de esterilización que no usan vapor, temperatura y formaldehído como agente esterilizante. No reutilizar indicadores biológicos.

### ► CADUCIDAD / REGISTRO ANVISA

El Indicador Biológico Fluorimétrico **CLICKTEST - IBFF2H (VBT)** tiene una validez de 02 años a partir de la fecha de fabricación. La información sobre el lote y la fecha de caducidad está impresa en el paquete y el tubo del indicador biológico. Producto exento de registro ante la ANVISA, según RDC 185/2001.

### ► ALMACENAMIENTO

Conserver protegido de la luz, a una temperatura entre 15°C y 30°C, y una humedad relativa entre 35% y 60%. No congelar. No almacenar en contacto con suelos y paredes o cerca de fuentes de calor, agentes esterilizantes y otros productos químicos.

**IMPORTANTE:** siempre transportar, almacenar, activar, incubar y desechar en posición vertical (tapa hacia arriba) para evitar fugas después de la activación del producto.

## EN BIOLOGICAL INDICATORS LOW TEMPERATURE STEAM AND FORMALDEHYDE 2H (IBFF2H)

### ► PRODUCT DESCRIPTION

The Clicktest Fluorometric Biological Indicator - IBFF2H (LTSF) was developed to monitor sterilization cycles from 121°C to 134°C in vacuum pump-assisted Auto-Reader Incubators, with air removal by gravity and FLASH cycle. It makes it possible to efficiently and safely prove the microbiological lethality of sterilization cycles.

Its innovative design dispenses glass components and, combined with an exclusive activation system, simplifies use and provides safe handling by preventing any risk of accidents.

The Clicktest Fluorometric Biological Indicator - IBFF2H (LTSF) is available in boxes of 50 units according to the AAMI/ISO 11138-1, AAMI/ISO 11138-3, and AAMI/ISO 11140-1 standards.

### ► COMPOSITION

Each Clicktest Fluorometric Biological Indicator - IBFF2H (LTSF) is made with a thermoplastic tube, stainless steel ACS, special filter, adhesive label with process chemical indicator (Type 1), the minimum population of  $1 \times 10^6$  of Geobacillus stearothermophilus spores (ATCC 7953) inoculated in paper strip (spore carrier). It also has a purple-colored growth medium contained in a casing and thermoplastic lid with holes, plus a vapor permeable barrier.

### ► INSTRUCTIONS FOR USE

1. Identify the Clicktest Fluorometric Biological Indicator - IBFF2H (LTSF) by writing the steriler number, cycle/load number, and processing date on its label.

2. Pack the biological indicator in a standardized package according to recommended sterilization practices and institution validated.

3. Place the package next to the materials to be sterilized, in an area considered critical (of greatest challenge) of the Auto-Reader Incubators, usually located near the door and next to the drain.

4. Select and activate the sterilization cycle corresponding to the load to be processed. At the end of the cycle, wait for the cooling time recommended by the Auto-Reader Incubators manufacturer, open the chamber and carefully remove the biological indicator from the inside package.

5. Verify that the Type 1 external chemical indicator (contained on the label) has changed from its pink (original) color to brown or black, confirming that it has been exposed to vapor at 121°C or above.

**Important:** The color change is not evidence that the sterilization cycle was successful. If there is no color change, it will be necessary to review the sterilization process.

6. Activate the Clicktest Fluorometric Biological Indicator - IBFF2H (LTSF). To do this, hold the ampoule and press the lid until you hear a "click", breaking the retaining seal of the culture medium. Shake it until all the liquid (culture medium) has completely descended from the lid and comes into contact with the spoke-bearing strip (see Quick Manual in this document).

7. Take another Clicktest Fluorometric Biological Indicator - IBFF2H (LTSF) that has NOT been subjected to the sterilization process to be used as a positive control, in order to validate the incubation conditions (temperature and time), the viability of the spores and the qualification of the culture medium. Both biological indicators (processed and positive control) must belong to the same manufacturing batch. Repeat step 1 (identification) and step 6 (activation).

8. Verify that the **fluorescence technology** incubator operates between 58°C and 62°C and that the programmed time is compatible with the two 02-hour biological indicators.

### FAST READING RESULT - FLUORIMETRIC METHODOLOGY

Incubate the 02 biological indicators (processed and positive control) for 02 hours. After the end of the incubation, observe:

a) if the incubator reader did **NOT** detect a fluorimetric reaction in the **processed indicator**, it characterizes a **negative result** and a successful sterilization cycle due to the inactivation of the spore population.

b) detecting fluorescence by the incubator means a **positive result** for the survival of microorganisms and a failed sterilization cycle.

9. Release the load/load for use only if the **processed Clicktest Fluorometric Biological Indicator - IBFF2H (LTSF)** presents a result "Negative - Absence of Microorganisms" and the **control indicator** results "Positive - Presence of microorganisms", confirming that the sterilization cycle was satisfactory and that the incubation was adequate.

**Note:** if the processed biological indicator shows a result "Positive - Presence of microorganisms" and, consequently, an irregularity in the sterilization cycle, the Hospital Infection Control Commission and Engineering/Maintenance must be notified to adopt the appropriate measures.

10. Detach the biological indicator labels (processed and positive control), attach them to the designated book/file and record the results obtained.

11. Dispose of the biological indicator tubes/ampoules following the sanitary regulations in your region. Positive indicators can be sterilized in cycles of 121°C for 15 minutes or 132°C for 10 minutes in gravitational Auto-Reader Incubators; or in cycles of 134°C for 04 minutes in vacuum pump-assisted Auto-Reader Incubators.

All materials that make up the Clicktest Fluorometric Biological Indicator - IBFF2H (LTSF) are 100% recyclable, following the MAXXIMED institutional plan of ecological design.

**Note:** if necessary, it is possible to confirm the result obtained by rapid reading, complementing it with colorimetric technology (reading by changing the color of the culture medium) as follows:

### RESULTS BY VISUAL READING

#### - Do not perform steps 9, 10, and 11 above.

- Check that the incubator is operating between 58°C and 62°C and incubate the 02 biological indicators for 24 hours to obtain the result by visual reading through colorimetric methodology (change of color of the culture medium). Since the presence of microorganisms can be detected before 24 hours, reading every 04 hours is recommended. Results:

a) maintenance of the purple color of the culture medium indicates the absence of viable microorganisms. Therefore, a successful sterilization process and **satisfactory result**.

b) change in the color of the culture medium, from purple to gray/greenish and later to yellow, indicates the presence/survival of microorganisms. Therefore, sterilization cycle failure and **unsatisfactory results**.

- Perform steps 9, 10, and 11 above.

**IMPORTANT:** The fast 02-hour fluorimetric reading and the optional 24-hour colorimetric reading are correlated with the 07 days incubation according to the FDA's reduced incubation time protocol (RIT), and its results have a correlation of > = 97 % of cases.

**CAUTION:** Do not use the Clicktest Fluorometric Biological Indicator - IBFF2H (LTSF) to monitor ethylene oxide sterilization cycles, dry heat, plasma/hydrogen peroxide vaporization, low-temperature steam and formaldehyde, chemical vapors, radiation, or other sterilization processes that do not use saturated steam as a sterilizing agent. Do not reuse biological indicators.

### ► VALIDITY / ANVISA REGISTRATION

The Clicktest Fluorometric Biological Indicator - IBFF2H (LTSF) has validity of 02 years from the date of manufacture. Information about the lot and due date are printed on the packaging and on the biological indicator tube. Product exempt from registration with Anvisa, according to RDC 185/2001.

### ► STORAGE

Store away from light at temperatures between 15°C and 30°C and relative humidity between 35% and 60%. Do not freeze. Do not store in contact with floors and walls or near heat sources, sterilizing agents, and other chemical products.

**IMPORTANT:** always transport, store, activate, incubate and discard in an upright position (lid up) to prevent leakage after product activation.